



UA.TR.099

# Інструкція із застосування

## Голови для контруктового наконечника від Ендо мотор C-SMART

Моделі: C1-16M

C1-17M

C1-19M

C4-1M

C4-19M

C4-2M

C5-4M

Цей виріб являє собою стоматологічний аксесуар до Ендо мотора.

Використовується з метою лікування кореневих каналів зубів.

Потребує під'єднання до ручки Ендо мотора.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію із застосування перед початком роботи, а також зберігайте її для подальшого користування.




### Попередження

- Прочитайте інструкцію перед початком роботи, щоб повністю зрозуміти функції виробу, а також зберігайте її для подальшого користування.
- Перед користуванням перевірте за межами ротової порожнини пацієнта наявність вібрації, шуму чи перегріву. У разі виявлення будь-яких відхилень негайно припиніть використання голови для контруктового наконечника й зверніться до продавця.
- Не намагайтесь розбирати голову для контруктового наконечника або втрутатися в роботу механізму.
- Не приєднуйте й не від'єднуйте голову для контруктового наконечника або бора, доки приводний двигун повністю не зупиниться.
- Якщо виріб працює неправильно, негайно припиніть роботу й зверніться до свого дилера.
- Натискання кнопки під час роботи голови для контруктового наконечника може привести до перегріву, серйозних технічних пошкоджень та ймовірного передчасного виходу з ладу голови для контруктового наконечника.
- Використовуючи виріб, уникайте контакту з будь-якими тканинами порожнини рота, оскільки це може привести до натискання кнопки під час роботи голови для контруктового наконечника.
- Не використовуйте дуже кислу воду чи стерилізувальні розчини для протирання, занурення або очищення виробу.
- Вироби постачаються в нестерильному стані, тому їх слід простирилізувати перед використанням.
- Якщо виріб не використовується протягом тривалого періоду, перевірте коректність його роботи до чергового застосування на пацієнти.
- Не занурюйте голову контруктового наконечника в будь-який хімічний розчинник або розчин, а також не дезінфікуйте сухим способом. Пропонується стерилізація в автоклаві за температури 134°C і тиску 0,22 МПа.

### 1. Під'єднання/від'єднання голови для контруктового наконечника до/від мотора

- Голову для контруктового наконечника можна під'єднати до наконечника мотора в 6 регульованих положеннях голови. Вирівняйте виступи з метою розташування на голові для контруктового наконечника й пази для розташування на наконечнику мотора, вставте голову до характерного класання.
- Під час від'єднання голови для контруктового наконечника витягніть її аксіально.

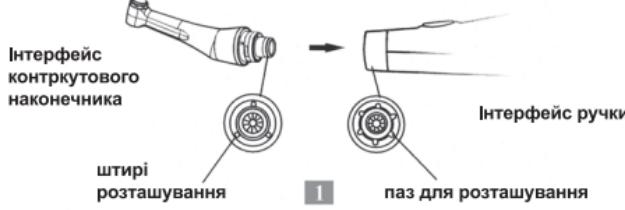


### Попередження

- Під час під'єднання та від'єднання голови для контруктового наконечника заздалегідь вимкніть живлення.
- Перевірте, чи голова для контруктового наконечника надійно прикріплена до наконечника мотора.

### 2. Встановлення й від'єднання файла

- Встановіть файл у роз'єм до упору.
- Злегка повертайте файл, поки він не з'єднається із засувним механізмом. Натисніть до класання.
- Від'єднання файла: відіжміть кнопку й витягніть файл (рис. 2).

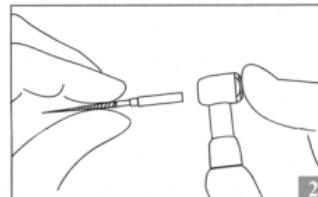


### Обережно:

- Використовуйте бор, який має відповідний стандартний діаметр (СА Ø 2,35 мм).
- Установлюючи й виділяючи файл, заздалегідь вимкніть живлення.
- Після встановлення файла легенько потягніть за нього: переконайтесь, що файл надійно закріплений.
- Завжди очищайте хвостовик файла перед установленням, оскільки потрапляння бруду в роз'єм може привести до погіршення сили замикання.

### 3. Заміна картриджа

- Ослабте сполучну втулку проти годинникової стрілки, зніміть голову й приводний вал.
- Розташуйте відповідний ключ на насадці голови, потім поверніть ключ проти годинникової стрілки, щоб ослабити насадку, і зніміть її.
- Вставте новий картридж у голову.
- Повністю вставте картридж, доки торцева поверхня картриджка не вирівнюється з торцевою поверхнею голови наконечника (рис. 3).
- Затягніть насадку голови ключем / викруткою, що додається, і зберігіть деталі.

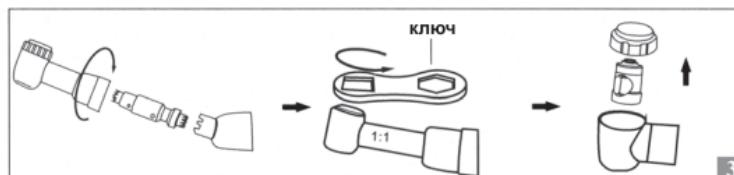

3

## 4. Технічне обслуговування



### Обережно:

Після кожного використання або перед кожним калібруванням і автоклавуванням.

### 4.1 Очищення

Очистіть голову від бруду й залишків та протріть її ватним тампоном або тканиною, просоченою спиртом. Не використовуйте дротяну щітку.

### 4.2 Стерилізація

Голову для контруктового наконечника можна автоклавувати за температури не вищої ніж 134°C.



### Обережно:

- Не мийте й не витирайте наконечник у розчині з окислювальним потенціалом (сильна кислота, суперкислий розчин) або розчині для стерилізації.
- Не автоклавуйте обладнання, що має залишки хімічної речовини: це може призвести до відшарування покриття чи мати шкідливий вплив на внутрішні деталі.
- Зберігайте його в місці, де наконечник не контактує з повітрям, яке містить пил, сірку або солі.
- Не торкайтесь наконечника: відразу після автоклавування він дуже гарячий.

### 4.3 Змащення

- Від'єднайте ручку від мотора.
- Зніміть бор з ручки.
- Установіть наконечник сопла в отвір розпилювача (рис. 4).
- Вставте наконечник сопла в отвір для подання повітря в ручку. Тримайте ручку й розпилюйте протягом приблизно 2–3 секунд. Продовжуйте наносити лубрикант, допоки він не буде виходити з голови для наконечника протягом щонайменше 2 секунд (рис. 4).



## 5. Транспортування та зберігання

### Умови експлуатації:

Температура

навколишнього середовища: від +5°C до +40°C

Відносна вологість: 20% – 80% RH

Атмосферний тиск: 86 кПа – 106 кПа

### Умови транспортування та зберігання:

Температура

навколишнього середовища: від -10°C до +55°C

Відносна вологість: ≤93 %RH

Атмосферний тиск: 50 кПа – 106 кПа

## 6. Тлумачення символів

	Засторога. Попередження		Робоча частина типу В
	Можна стерилізувати в паровому стерилізаторі за температури 134°C		Зверніться до інструкції із застосування
	Виробник		Користуйтесь інструкцією із застосування
	Дата виготовлення		Код партії
	Використати до		Знак відповідності Європейській Директиві
	Знак відповідності технічним регламентам		Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві

### Гарантія

Виробник надає користувачеві гарантію 12 місяців на весь асортимент своєї продукції, окрім кулькопідшипникових наконечників (гарантія на них становить 3 місяці), з дати виставлення рахунка-фактури.

Foshan COXO Medical Instrument Co., Limited, BLDG 4 District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue, Nanhai District, Foshan 528226 Guangdong China / ФОШАНЬ КОКСО МЕДІКЛ ІНСТРУМЕНТ КО., ЛІМІТІД, Будівля 4, район Ей, Гуандун Нью Лайт Сурс Індастріел Бейс, Сауф оф Лукан Авеню, район Нанхай, місто Фошань, 528226 Гуандун, Китай, Tel./Tel.: +86 757 66692050, e-mail: coxosale8@gmail.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д оф. 117, тел.: +380934477575, e-mail: dir\_ollen@ukr.net